


赤枠・赤矢印は異常発生時

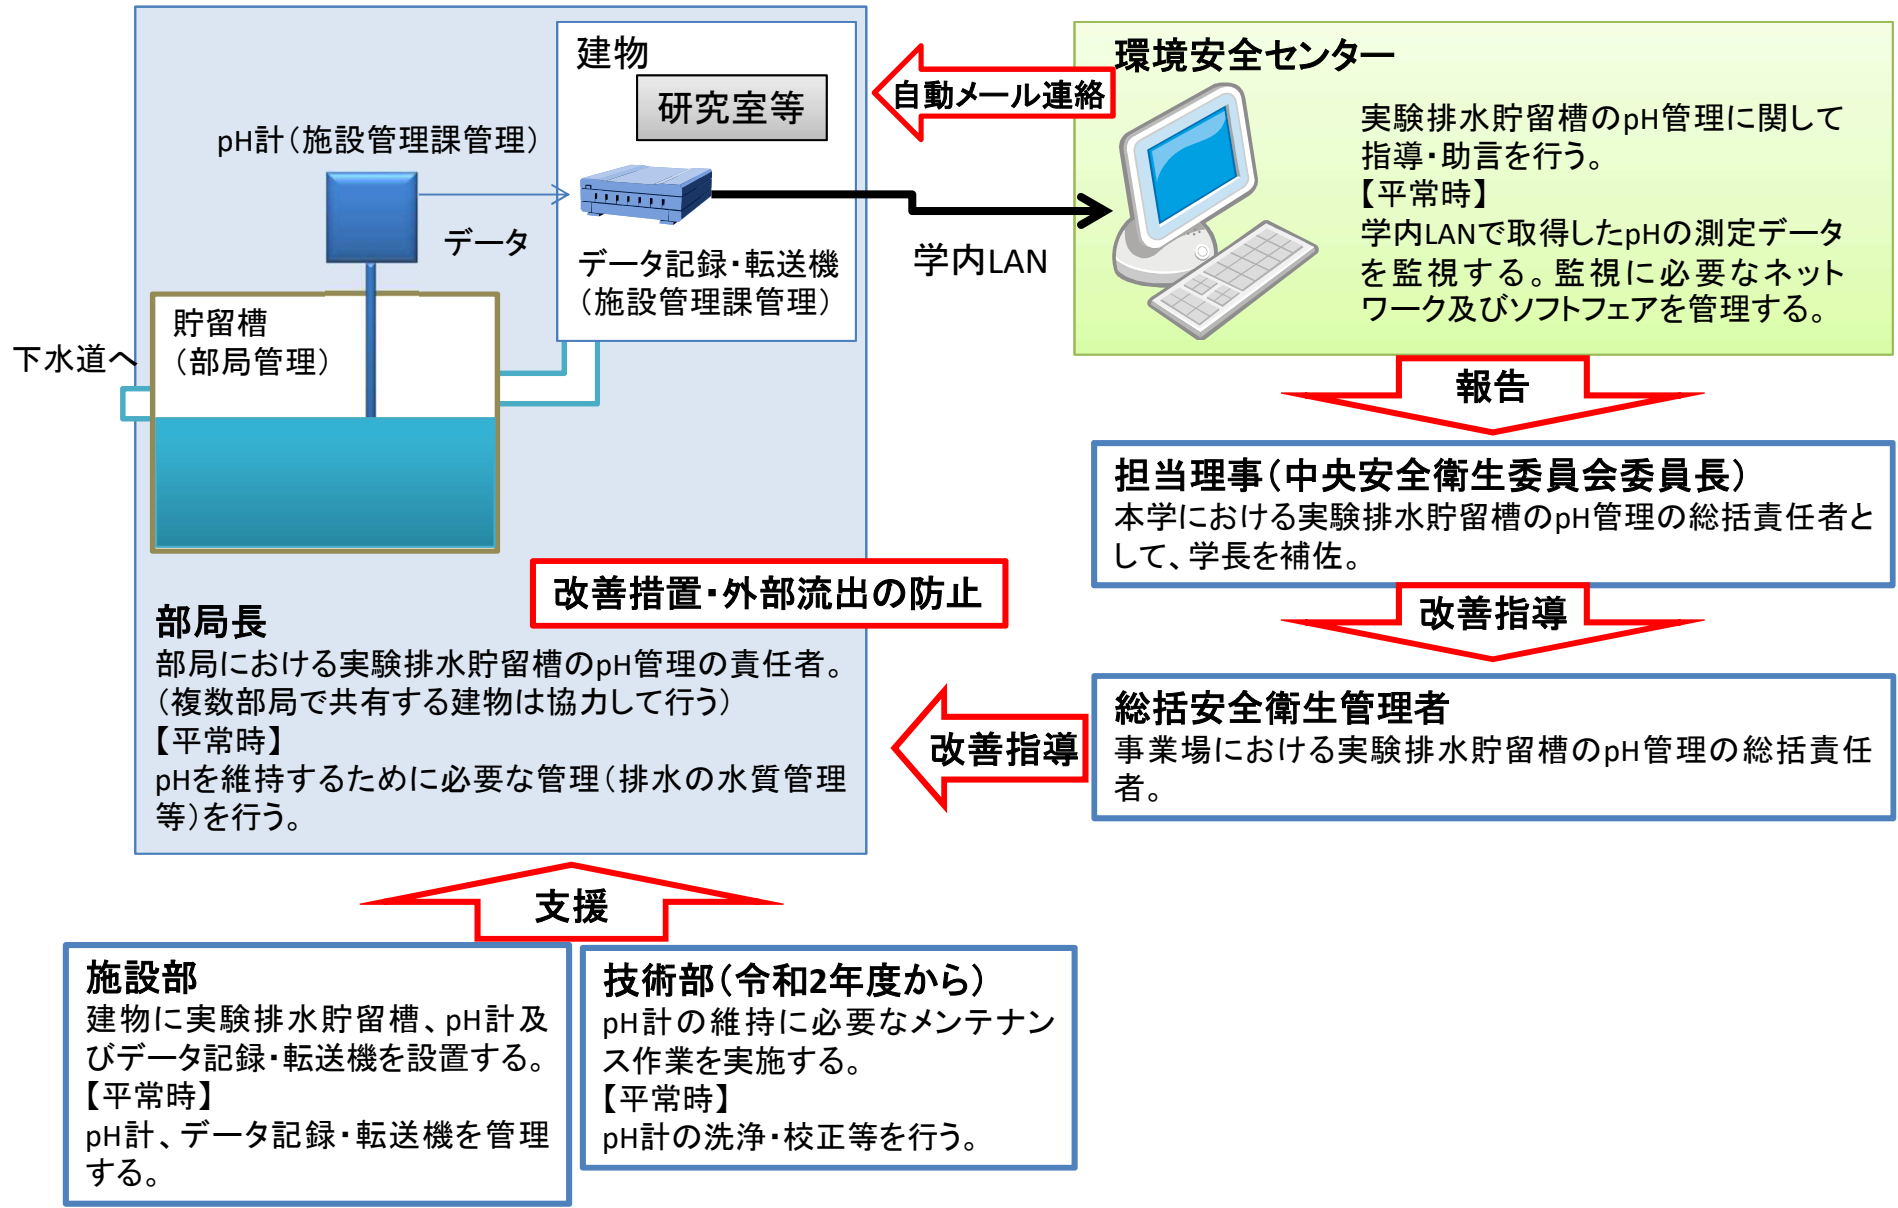

改善措置・外部流出の防止

**担当理事(中央安全衛生委員会委員長)**  
本学における実験排水貯留槽のpH管理の総括責任者として、学長を補佐。

改善指導

**総括安全衛生管理者**  
事業場における実験排水貯留槽のpH管理の総括責任者。

支援

**施設部**  
建物に実験排水貯留槽、pH計及びデータ記録・転送機を設置する。  
【平常時】  
pH計、データ記録・転送機を管理する。

**技術部(令和2年度から)**  
pH計の維持に必要なメンテナンス作業を実施する。  
【平常時】  
pH計の洗浄・校正等を行う。

**部局長**  
部局における実験排水貯留槽のpH管理の責任者。  
(複数部局で共有する建物は協力して行う)  
【平常時】  
pHを維持するために必要な管理(排水の水質管理等)を行う。

**環境安全センター**  
実験排水貯留槽のpH管理に関して指導・助言を行う。  
【平常時】  
学内LANで取得したpHの測定データを監視する。監視に必要なネットワーク及びソフトウェアを管理する。

**建物**  
研究室等  
データ記録・転送機  
(施設管理課管理)

pH計(施設管理課管理)  
データ  
貯留槽  
(部局管理)  
下水道へ

自動メール連絡  
学内LAN

報告

改善指導